

Temperature Log

The Jikei University Hospital
 Refrigerator Name: MPR-514-PJ
 Temperature Logger/ID : RTR501BL/ 52802EFE (Calibration date ; 29 Sep 2025)


Location : Pharmaceutical department
 Acceptable Temperature Range : 2°C to 8°C

※The certification period is one year from the date of calibration.

Month/Year (年月) (MMM/YYYY) : <u>May/2026</u>	Confirmation Time 確認時間	Alarm: No or Yes アラームの有無	Initials (確認者)
Date(日)			
1	:	No · Yes	
2	<u>9 : 00</u>	<input checked="" type="radio"/> No · Yes	<u>R.Y</u>
3	:	No · Yes	
4	:	No · Yes	
5	:	No · Yes	
6	:	No · Yes	
7	<u>9 : 00</u>	<input checked="" type="radio"/> No · Yes	<u>S.H</u>
8	<u>11 : 00</u>	<input checked="" type="radio"/> No · Yes	<u>S.H</u>
9	<u>10 : 00</u>	<input checked="" type="radio"/> No · Yes	<u>S.H</u>
10	:	No · Yes	
11	<u>10 : 50</u>	<input checked="" type="radio"/> No · Yes	<u>S.H</u>
12	<u>8 : 35</u>	<input checked="" type="radio"/> No · Yes	<u>R.Y</u>
13	<u>11 : 25</u>	<input checked="" type="radio"/> No · Yes	<u>S.H</u>
14	<u>9 : 00</u>	<input checked="" type="radio"/> No · Yes	<u>S.H</u>
15	<u>8 : 30</u>	<input checked="" type="radio"/> No · Yes	<u>S.H</u>
16	<u>11 : 00</u>	<input checked="" type="radio"/> No · Yes	<u>S.H</u>
17	:	No · Yes	
18	<u>8 : 30</u>	<input checked="" type="radio"/> No · Yes	<u>S.H</u>
19	<u>8 : 30</u>	<input checked="" type="radio"/> No · Yes	<u>S.H</u>
20	<u>8 : 30</u>	<input checked="" type="radio"/> No · Yes	<u>S.H</u>
21	<u>8 : 40</u>	<input checked="" type="radio"/> No · Yes	<u>Y.N</u>
22	<u>9 : 30</u>	<input checked="" type="radio"/> No · Yes	<u>S.H</u>
23	<u>11 : 50</u>	<input checked="" type="radio"/> No · Yes	<u>S.H</u>
24	:	No · Yes	
25	<u>8 : 30</u>	<input checked="" type="radio"/> No · Yes	<u>Y.N</u>
26	<u>12 : 50</u>	<input checked="" type="radio"/> No · Yes	<u>S.H</u>
27	<u>8 : 30</u>	<input checked="" type="radio"/> No · Yes	<u>S.H</u>
28	<u>15 : 00</u>	<input checked="" type="radio"/> No · Yes	<u>S.H</u>
29	<u>9 : 30</u>	<input checked="" type="radio"/> No · Yes	<u>R.Y</u>
30	<u>11 : 00</u>	<input checked="" type="radio"/> No · Yes	<u>R.Y</u>
31	:	No · Yes	

Investigational Product Manager's Signature: Shunsuke Hirasawa Date: 01-Jun-2026

Shunsuke Hitosugi 01-Jun-2026

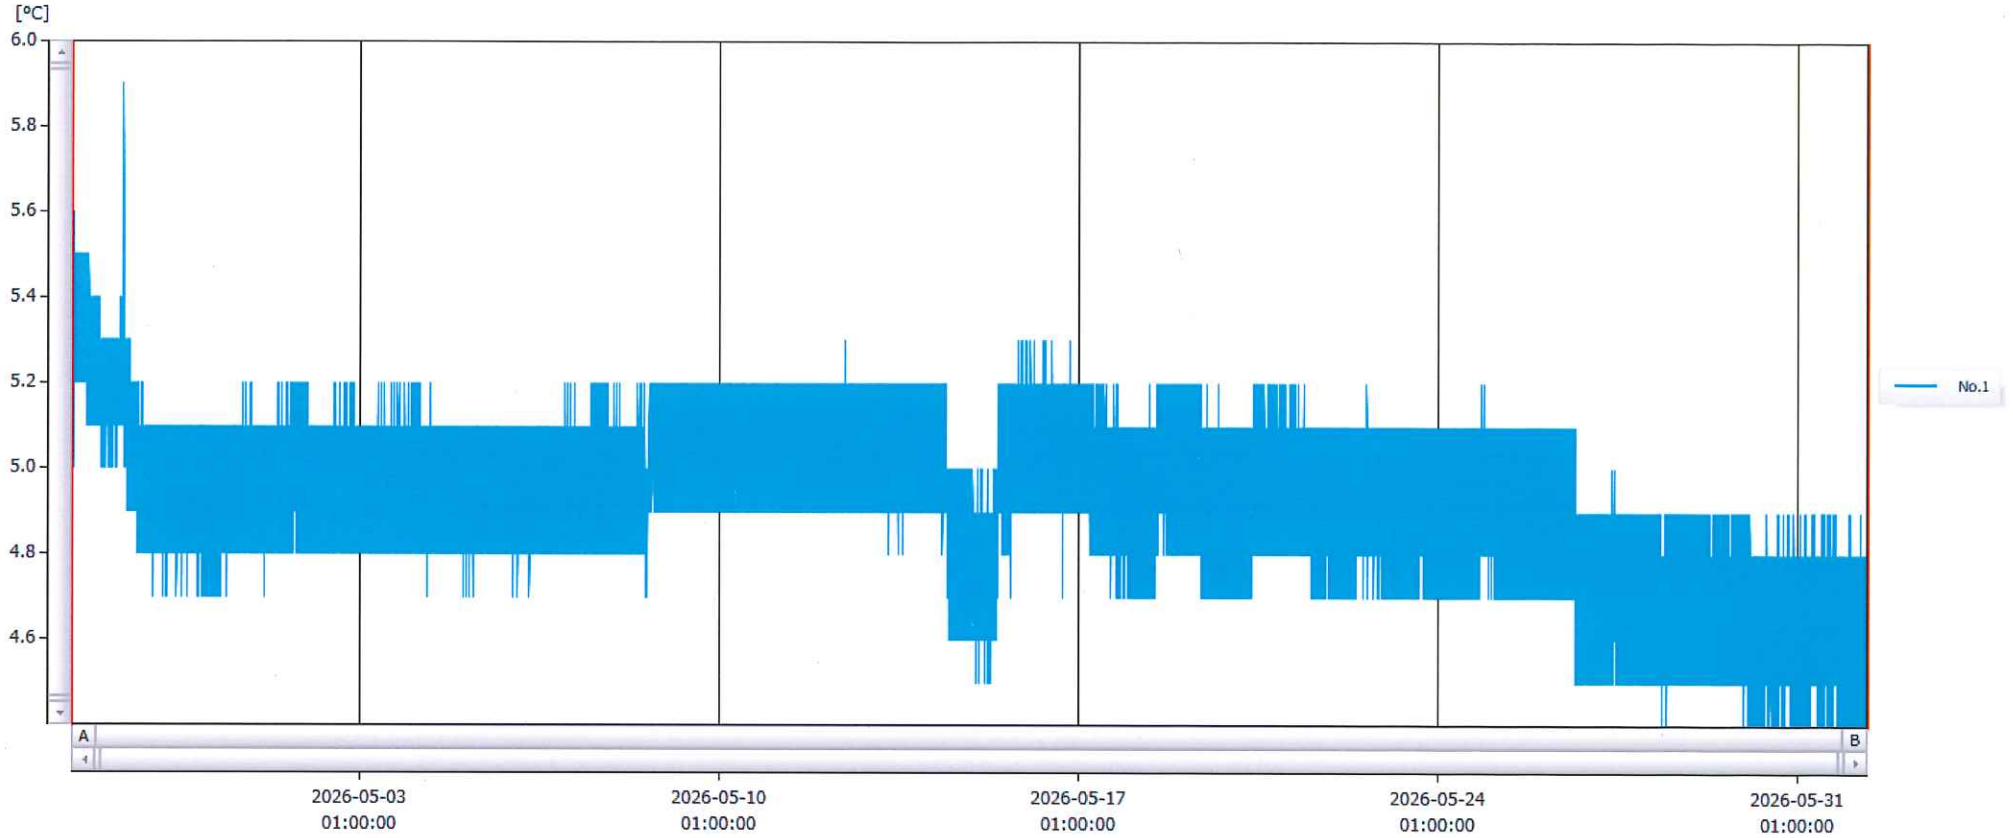

表示範囲 2026-04-27 10:04:00 - 2026-06-01 09:55:00
 計算範囲 2026-04-27 10:04:00 - 2026-06-01 09:55:00

No.	チャンネル名	記録間隔	データ数	単位	最大値	最小値	平均値
No.1	冷所B	5 min.	10079	°C	5.9	4.4	4.9