Temperature Log

The Jikei University Hospital
Location : Pharmaceutical department　　Acceptable Temperature Range : Room temperature
Temperature Logger/ID : RTR501BL/ 52805111 (Calibration date ; 18 Aug 2026)
※The certification period is one year from the date of calibration.


Month/Year（年月）(MMM/YYYY) : Oct/2026 Date(日)	Confirmation Time 確認時間	Alarm: No or Yes アラームの有無	Initials (確認者)
1	16 : 30	No · Yes	S.H
2	17 : 00	No · Yes	S.H
3	9 : 30	No · Yes	S.H
4	:	No · Yes	
5	10 : 00	No · Yes	S.H
6	14 : 40	No · Yes	R.Y
7	16 : 30	No · Yes	S.H
8	11 : 30	No · Yes	S.H
9	9 : 00	No · Yes	S.H
10	*~~9~~ :	No · Yes	
11	:	No · Yes	
12	:	No · Yes	
13	9 : 25	No · Yes	R.Y
14	17 : 00	No · Yes	S.H
15	12 : 00	No · Yes	S.H
16	9 : 00	No · Yes	S.H
17	9 : 00	No · Yes	S.H
18	:	No · Yes	
19	11 : 30	No · Yes	S.H
20	11 : 00	No · Yes	S.H
21	12 : 00	No · Yes	S.H
22	11 : 30	No · Yes	S.H
23	9 : 15	No · Yes	S.H
24	9 : 00	No · Yes	S.H
25	:	No · Yes	
26	9 : 00	No · Yes	S.H
27	15 : 00	No · Yes	R.Y
28	10 : 15	No · Yes	R.Y
29	14 : 00	No · Yes	S.H
30	11 : 00	No · Yes	R.Y
31	11 : 40	No · Yes	R.Y

*error 10/Oct/2026 S.H

Investigational Product Manager's Signature: Shunsuke Hitosugi　　Date: 02 Nov 2026

T&D Graph 2026-11-02 16:35:08

Shunsuke Hitosugi; 02 Nov 2026

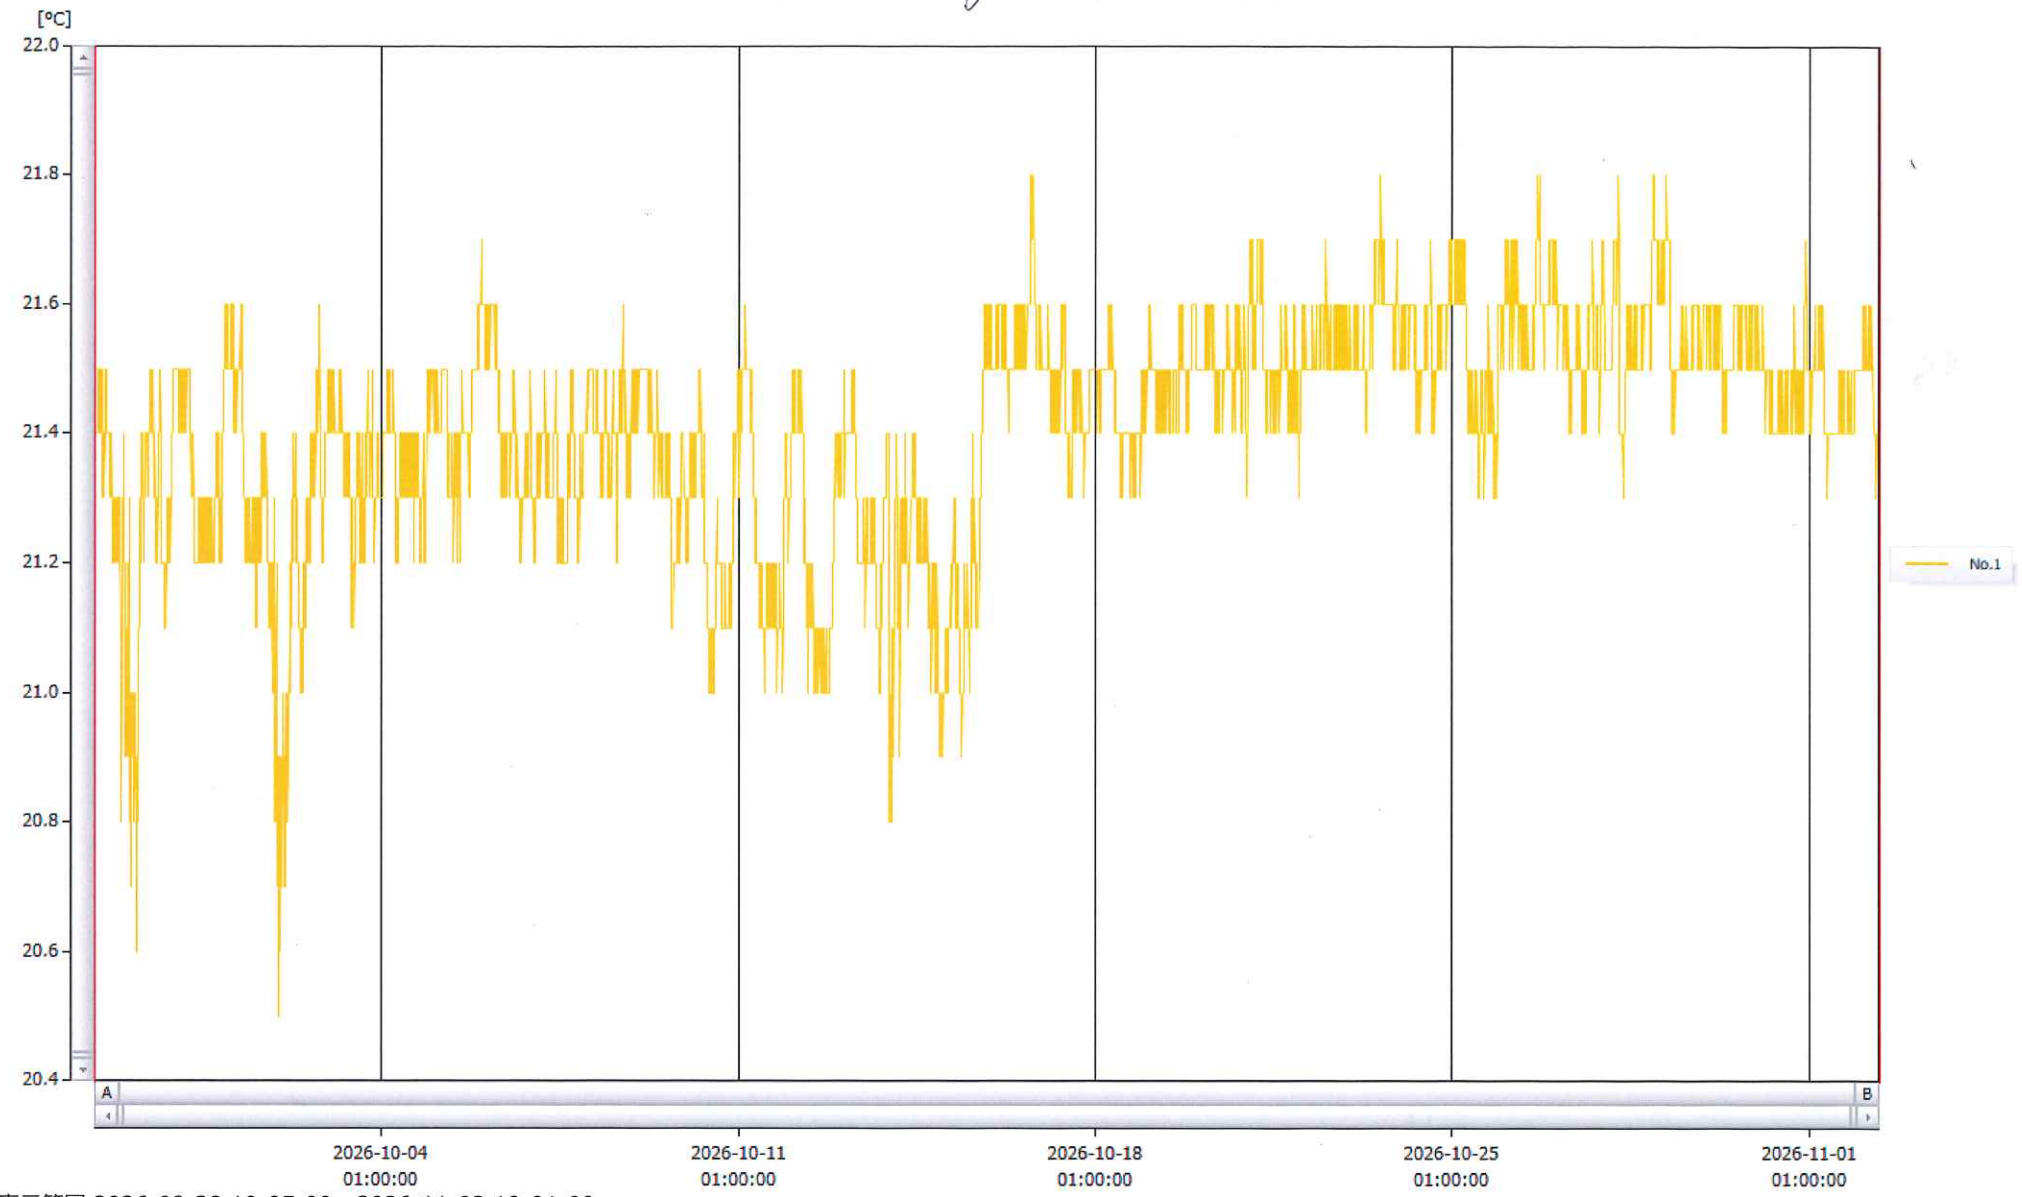

表示範囲 2026-09-28 10:05:00 - 2026-11-02 10:01:00
計算範囲 2026-09-28 10:05:00 - 2026-11-02 10:01:00

No.	チャンネル名	記録間隔	データ数	単位	最大値	最小値	平均値
No.1	室温2609	5 min.	10080	℃	21.8	20.5	21.4